


# Gamma- und Neutronendosisleistung (ICRP 60) ausgewählter CASTOR-Behälter



# Gamma and Neutron Radiation Dose Rate (ICRP 60) of CASTOR-Flasks

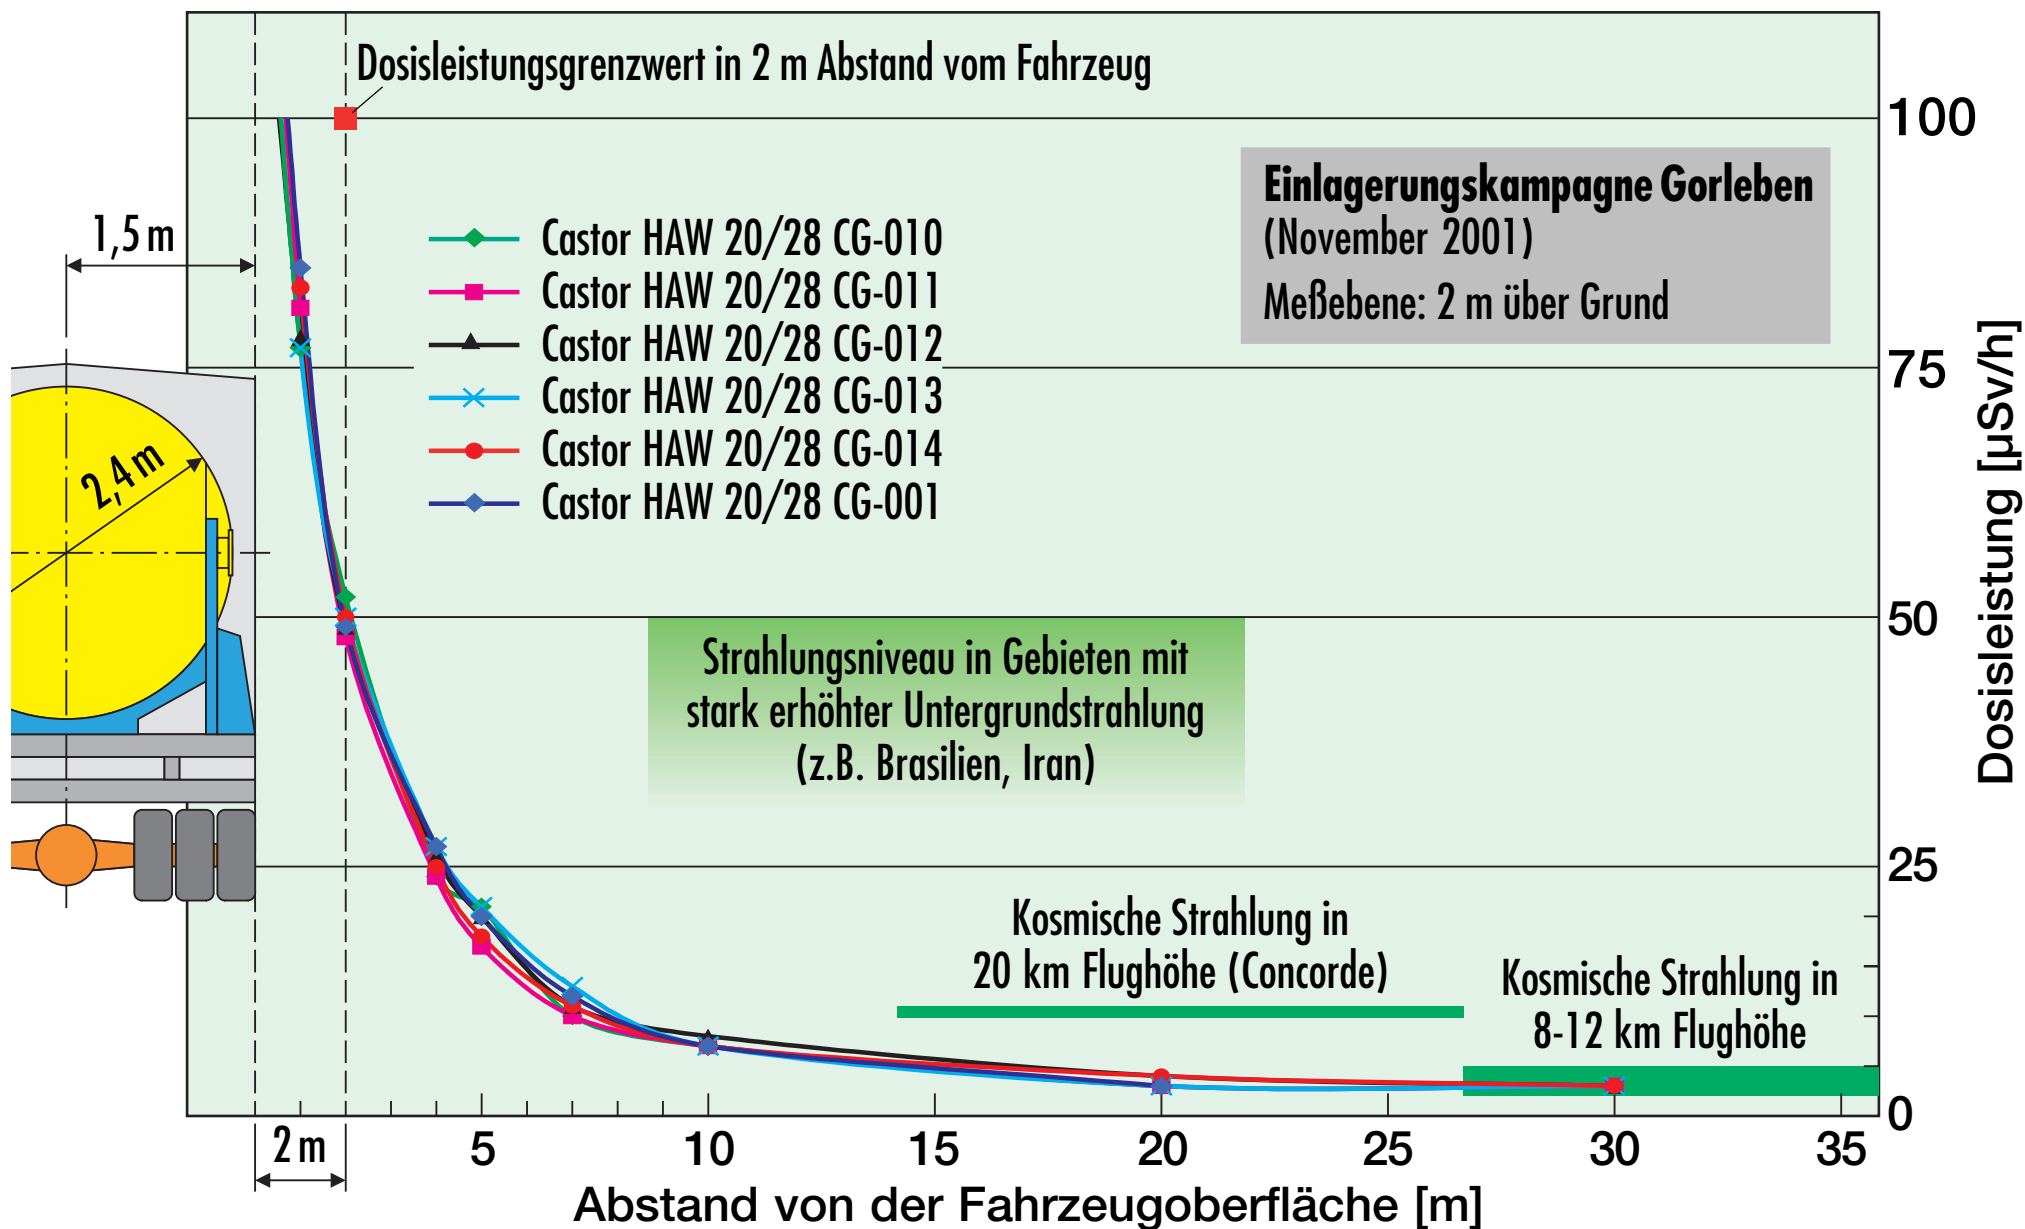